

SM2123M

4-20mA 电流型液体 PH 值传感器





网址: http://www.sonbest.com

产品概述

SM2123M PH 值传感器为 4-20mA 电流型 PH 值传感器,可实现多点同时监测, 组网并远传。

适用于各种场所,尤其适用于土壤、污水处理等场所。

为便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的 MODBUS-RTU 通讯协议, 支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数 据的查询和设置。

使用维护及注意事项

- 1、电极在测量前必须用已知 PH 值的标准缓冲溶液进行定为校准,为取得更正确的 结果,已知PH 值要可靠,而且其PH 值愈接近被测值愈好。
- 2、取下电极保护套后要注意,在塑料保护栅内的敏感玻璃泡不与硬物接触,任何破 损和擦毛都会使电极失效。
- 3、测量完毕,不用时应将电极保护套套上,保护套内应放少量 3.3mol/L 氯化钾溶液, 以保持电极球泡的湿润。
- 4、电极的引出端,必须保持清洁和干燥,绝对防止输出两端短路,否则将导致测量 结果失准或失效。
- 5、电极避免长期浸在蒸馏水中货蛋白质溶液和酸性氟化物溶液中,并防止和有机硅 油脂接触。
- 6、电极经长期使用后,如发现梯度略有极爱内地,则可把电极下端浸泡在 4%HF(氢 氟酸)中3-5秒钟,用蒸馏水洗净,然后在氯化钾溶液中浸泡,使之复新。
- 7、被测溶液中如含有易污染敏感球泡货堵塞液接界的物质,而使电极钝化,其现象 是敏感梯度降低, 货读数不准。如此, 则应根据污染物质的性质, 以适当溶液清洗, 使之复新。
- 8、凡需测量能溶解聚碳酸树脂的有机溶剂,请选用 PH 符合电极中玻璃外壳型号电 极。
- 注:选用清洗剂时,如能溶解聚碳酸树脂的清洗液,如四氯化碳,三氯乙烯,四氢呋 喃等,则可能把聚碳酸树脂溶解后,涂在敏感玻璃球泡上,而使电极失效,请慎用!


技术参数及特点

测量范围	0 到 14 pH	
分辨率	0.01 pH	
精度	±0.5 pH	
反应时间	14 秒	
缓冲液识别	自动识别	
适用温度范围	0° C65° C	
输出电流	4-20mA	
电源	DC12—24V	
外形尺寸	$115\times96\times30\text{mm}^3$	

使用说明

1. 接线

设备自带一根约 0.5 米左右的引线供用户测试使用,需延长时,用户可以直接将电缆接入到设备内部接线座。

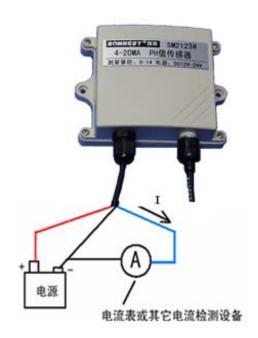

内部接线座引脚定义

引线	标号	说明
1	V+	电源正, 电压范围: DC12-30V
2	I +	电流输出正极
3	NC	空脚
4	V –	电源负极

2. PH与电流计算

测量电流 I、量程 PH 值量程 A 及 PH 值电值的关系:

PH = A*(I-4)/(20-4)

如果当前测量的电流值为 8mA,量程为 14, 那此时算出当前 PH 值为: PH=14*(8-4)/(20-4)=3.5,即当前 PH 值为 3.5。

常用 PH 与电流对照表

电流值 (mA)	PH 值	说明
4	0	量程下限
8	3.5	
12	7	中性
16	10.5	
20	14	量程上限

安装尺寸



通讯协议

设备所有操作或回复命令都为 16 进制数据。默认通讯波特率: 9600,8,n,1。

基本命令格式:

[设备地址][功能码][起始地址: 2字节][数据长度: 2字节][CRC16校验] 意义如下:

A、设备地址:设备地址范围为 1-35,其中 250 即 0xFA 为通用查询地址,当不知道设备地址时,可用此通用查询地址进行查询。

- B、功能码:不同的应用需求功能码不同,比如3为查询输入寄存器数据。
- C、起始地址: 查询或操作寄存器起始地址。
- D、数据长度: 读取的长度。

E、CRC 校验: CRC16 校验, 高位在前, 低位在后。

1) 读取数据(功能码为 0x03)

[设备地址][03][起始地址: 2字节][数据长度: 2字节][CRC16校验]注: 数据长度为 2字节, PH 值查询数据长度固定为 0x00 01

设备响应:

[设备地址][命令号][返回的字节个数][数据 1][CRC16 校验] 响应数据意义如下:

A、返回的字节个数:表示数据的字节个数,也就是数据1,2...n中的n的值。

B、数据 1···N: 各个传感器的测量值, PH 值数据占用 2 个字节。为整型数据。

例如: 查询 1 号设备上 CO2 含量值传感器数据:

发送: 01 03 00 00 00 01 84 0A

回应: 01 03 02 02 6B F8 CB

上例回复数据中: 01 表地址 1,02 表数据长度为 2 个字节,由于测点数据长度占 2 个字节,比如第 1 个数据为 02 6B (都是十六进制), 折成 10 进制方法:

V=256*0x02+0x6B=619.

即为: 619, 即实际值为 6.19。

在组态软件中, 寄存器对照表:

序号	名称	寄存器地址	数据类型
1	PH 值寄存器	40001	整型
2	量程缩放系数	40005	整型
3	偏移量寄存器	40006	整型

2) 更改设备地址(功能号: 0x06 辅助命令号: 0x0B)

发送命令格式:

[设备地址][命令号:0x06][辅助命令号:0x0B] [00 00] [目标地址:占 1 个字节] [CRC16] 说明:

A、目标地址: 值范围为 1-35, 目标地址与当前地址不能相同。

B、00 00 为十六进制数,为固定值,不可更改。

比如将设备地址 1, 更改为 2, 则命令为:

01 06 0B 00 00 02 0A 2F

设备响应: 02 25 01 02 90 06

设备响应格式: [设备地址][**查询设备地址**命令号] [数据长度:1 字节] [随机字节: 1 字节] [CRC16]

比如: 02 25 01 18 11 CD 表明更主后当前设备地址为 02。

3) 查询设备地址(功能号: 0x25 辅助命令号: 0x02)

若不知道当前设备地址、且总线上只有一个设备时,可以通过此命令查询当前设备地址。

发送命令格式:

[设备地址: 0xFA][命令号:0x25][辅助命令号: **0x**02] [00 00 01] [CRC16] 说明:

地址: 上海市中山北路 198 号 网址: http://www.sonbest.com 第 5 页 共 6 页

A、设备地址 0xFA 为通用设备查询地址。

B、00 00 01 为十六进制数,为固定值,不可更改。

比如查询当前设备地址,命令为 FA 25 02 00 00 01 99 FE

设备响应: 02 25 01 02 90 06

设备响应格式: [设备地址][命令号][数据长度:1字节][随机字节: 1字节][CRC16]

比如: 02 25 01 18 11 CD 表明设备地址为 02。

4) 量程缩放系数设置(功能号: 0x06 辅助命令号: 0x0A)

当数据与用户照度计或标准参照标准有误差时,我们可以通过调整量程缩放系数据 来减小显示误差。此参数用于设备出厂前校正,用户无校正设备,建议使用不要更改 此值。

发送命令格式:

[设备地址][命令号:0x06][辅助命令号: 0x0A][00][量程缩放系数][CRC16]

A、设备地址:当前设备地址。

B、辅助命令: 为固定值,不可更改。

C、**量程缩放系数**: 值范围 1000-65000,对应实际系数为 0.1000-6.5000。

如果当前值偏小,建议系数大于1,即该参数大于10000,如果当前值偏大,建议系数 1, 即该参数小于10000。

比如设置当前传感器量程放大 1.0010 倍, 那此参数值应该为 10010,对应十六进制为 0x 27 00.则设置命令为 01 06 0A 04 27 00 51 E8

设备响应: 01 04 27 00 DA 22

设备响应格式: [设备地址][命令号][参数值][CRC16]



上海搜博实业有限公司

电话: 021-51083595

中文网址: http://www.sonbest.com 英文网址: http://www.sonbus.com 地址:上海市中山北路 198号 21楼